

9.2. Internationales 10-20 Elektrodensystem

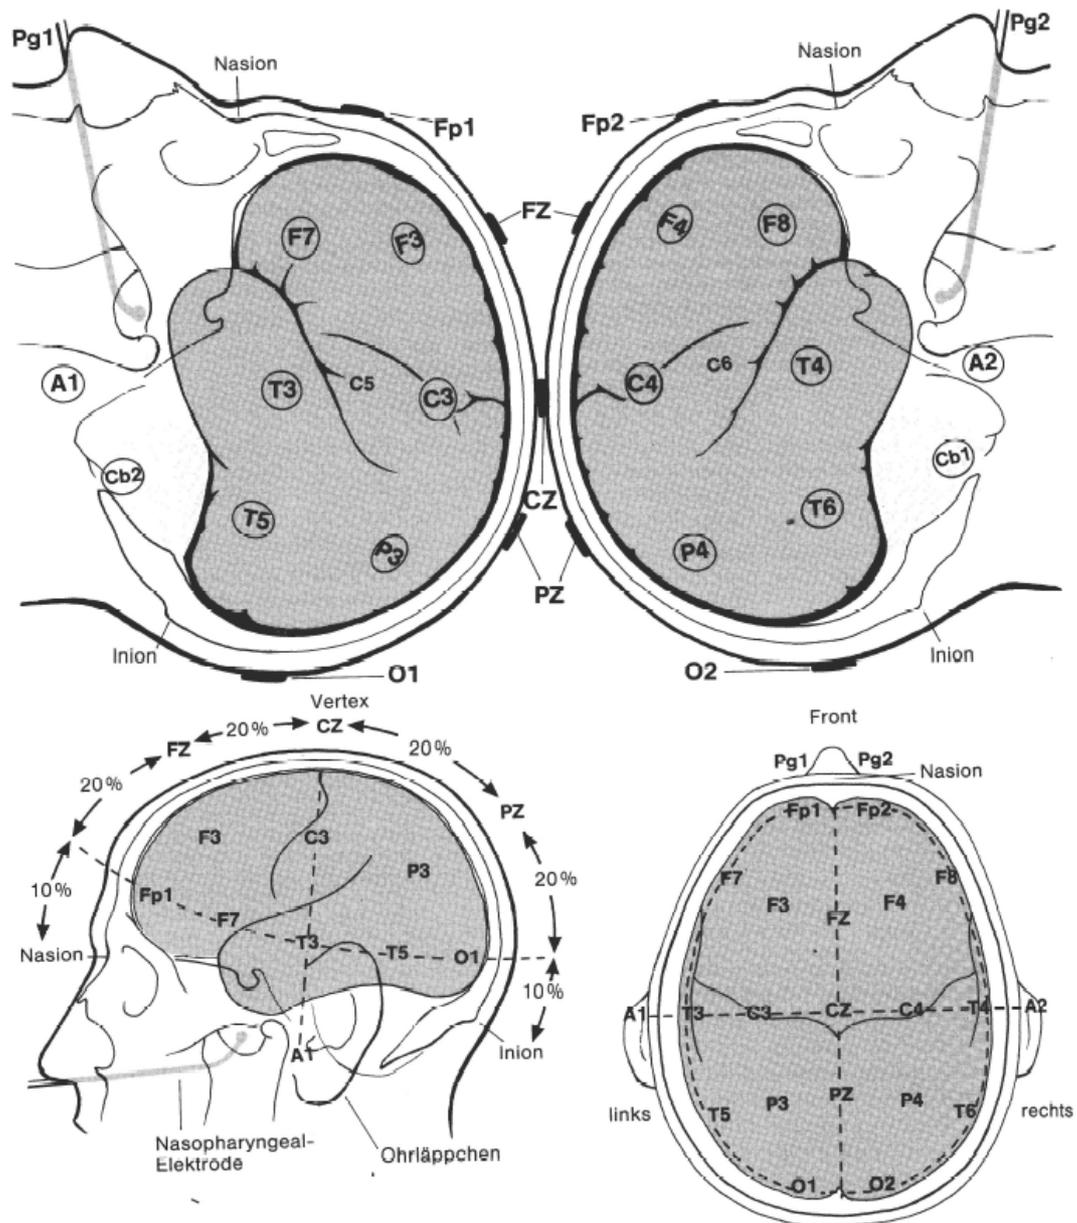


Abb.12: Internationales 10-20-System für die Platzierung der EEG Elektroden. (aus Jasper HH 1958)